ГТБВ.402152.009ГЧ

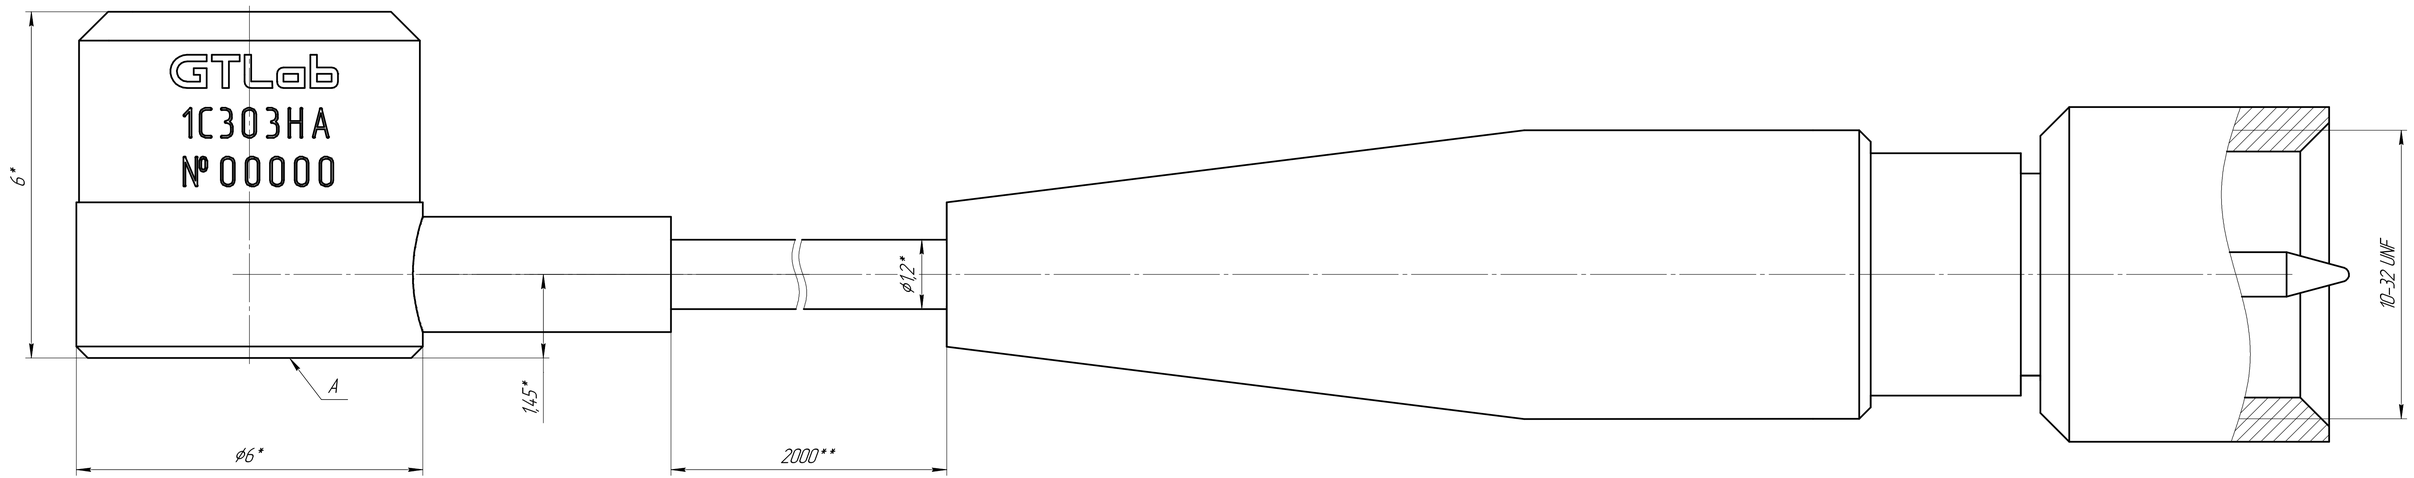

Схема электрическая соединений



1. *Размер для справок.
2. **Допускается изменение длины кабеля по требованиям заказчика.
3. Акселерометр 1С303НА крепить на объект испытаний на поверхность А с применение клея ВК-9 ОСТ В95 1653-75. Допускается крепление с применением термоклея и двухстороннего скотча.
4. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается акселерометр 1С303НА, должна быть с допуском плоскости 0,05 мм, с шероховатостью $\frac{25}{25}$

Обозначение	Наименование	Материал корпуса
ГТБВ.402152.009	1С303НА	Нержавеющая сталь
ГТБВ.402152.009-01	1С303НА-01	Титановый сплав

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гарин		09.07.2020
Пров.		Ситников		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Кирпичев		

ГТБВ.402152.009ГЧ

Акселерометр 1С303НА-XX Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		20:1

Лист | Листов 1

GTLab

Копировал | Формат А3×3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.