



ГТБВ.402159.005 ГЧ

Перв. примен.
Справ. №
Подл. и дата
Изм. № докл.
Взам. инв. №
Подл. и дата
Изм. № подл.

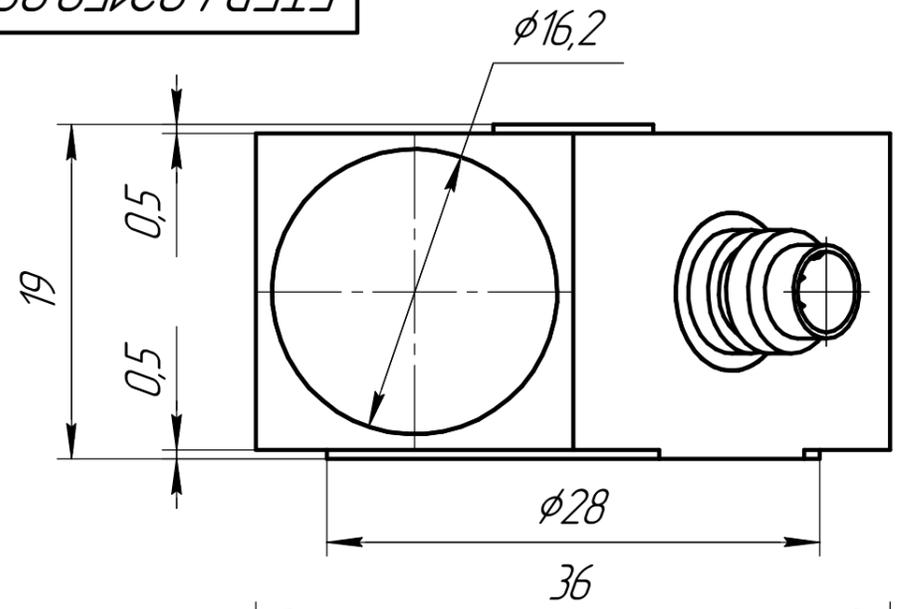

A

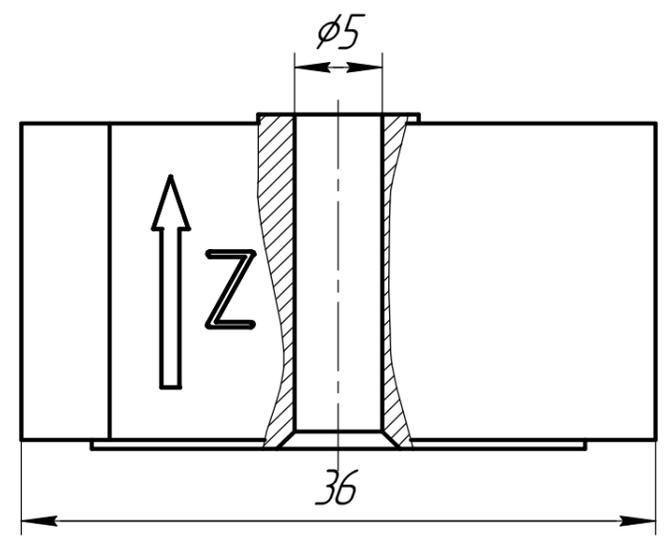

A



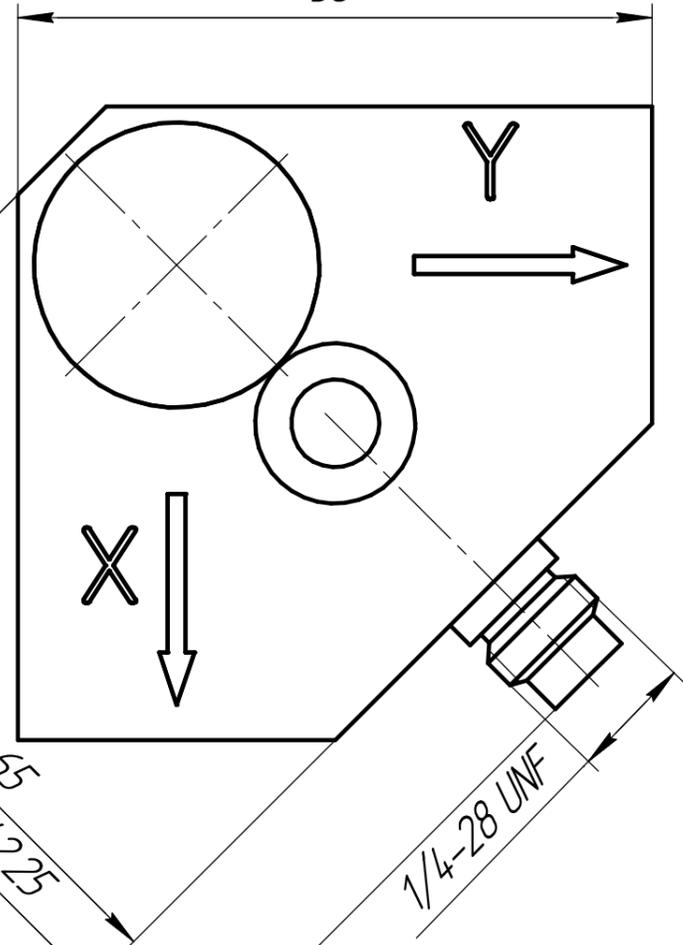


Схема электрическая принципиальная:

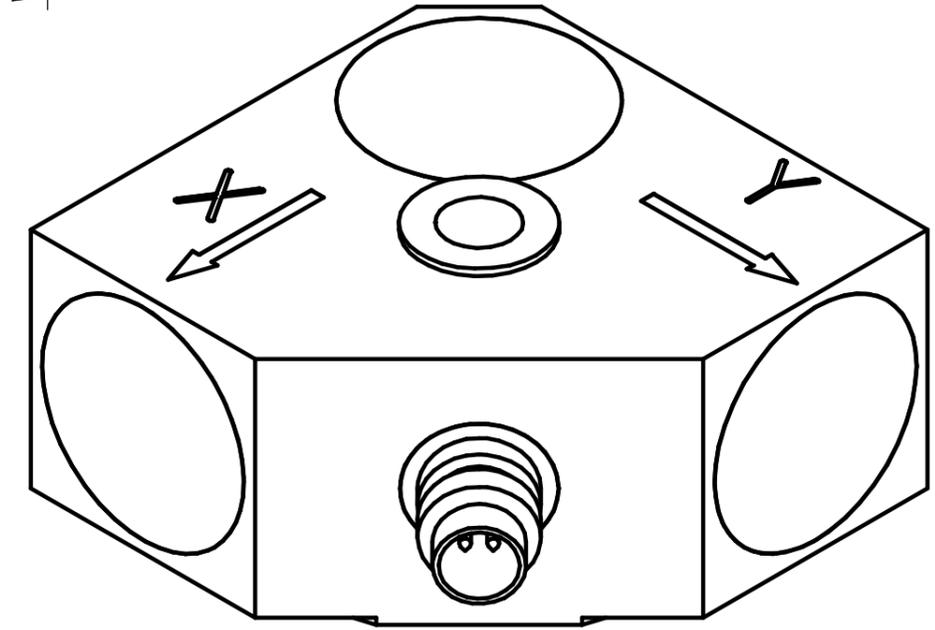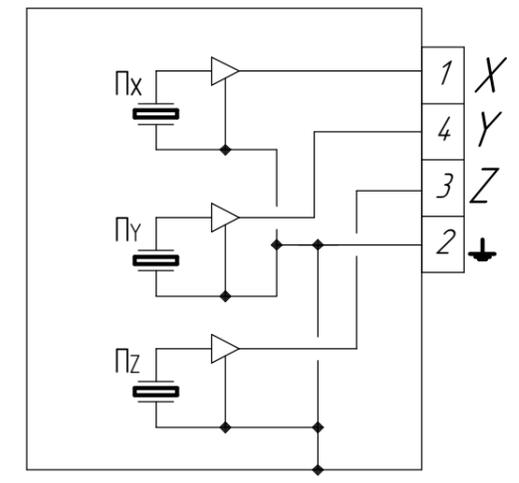

1. Размеры для справок;
2. Акселерометр крепить Винтом DIN 7984 – M5 x 25 из комплекта поставки с моментом 1,3...1,5Нм, контрить клеем;
3. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05, с шероховатостью $\sqrt{Ra}2.5$.

Обозначение	Наименование	Чувствительность
ГТБВ.402159.005	Акселерометр 1V154HC-100	100 мВ/г
ГТБВ.402159.005-01	Акселерометр 1V154HC-500	500 мВ/г
ГТБВ.402159.005-02	Акселерометр 1V154HC-1000	1000 мВ/г

ГТБВ.402159.005 ГЧ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
				30.06.2020		
Разраб.	Панкратов					
Проб.	Курпичев					
Т.контр.						
И.контр.						
Утв.	Курпичев					
Акселерометр 1V154HC-XX Габаритный чертеж					110,61 гр	2,5:1
					Лист	Листов
					ООО "ГлобалТест Лаб"	