ГТБВ.433642.018 ГЧ

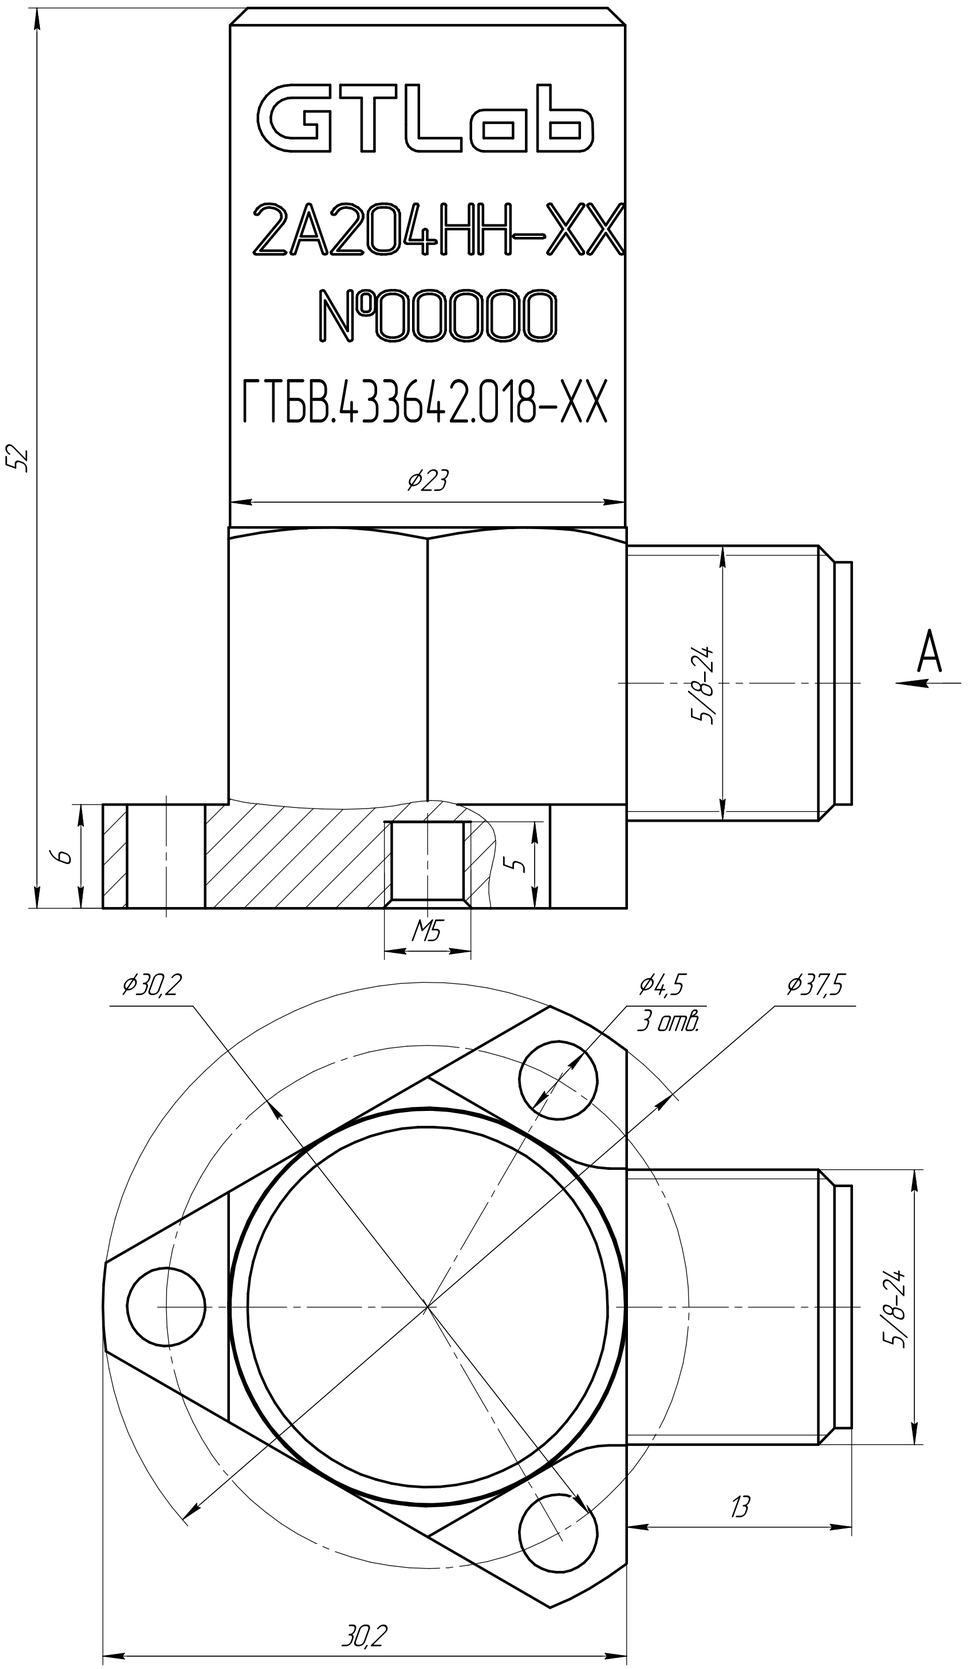


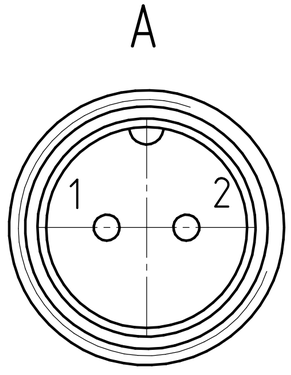


Схема электрическая соединений

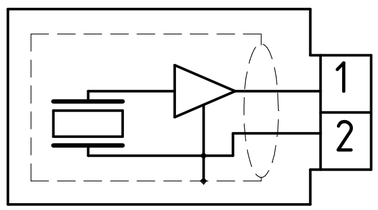


| Обозначение | Наименование | Маркировка взрывозащиты и температурный диапазон |
|---|---|---|
| ГТБВ.433642.018 | 2А204НН-10 | 0Ex ia IIC T6...T5 Ga<br>-40...+80°C |
| ГТБВ.433642.018-01 | 2А204НН-20 | |
| ГТБВ.433642.018-02 | 2А204НН-40 | |
| ГТБВ.433642.018-03 | 2А204НН-80 | |
| ГТБВ.433642.018-04 | 2А204НН-160 | |
| ГТБВ.433642.018-05 | 2А204НН-200 | |
| ГТБВ.433642.018-06 | 2А204НН-10 | 1Ex d IIC T6...T5<br>-40...+85°C |
| ГТБВ.433642.018-07 | 2А204НН-20 | |
| ГТБВ.433642.018-08 | 2А204НН-40 | |
| ГТБВ.433642.018-09 | 2А204НН-80 | |
| ГТБВ.433642.018-010 | 2А204НН-160 | |
| ГТБВ.433642.018-011 | 2А204НН-200 | |
| ГТБВ.433642.018-012 | 2А204НН-10(Т) | 0Ex ia IIC T6...T4 Ga<br>-40...+120°C |
| ГТБВ.433642.018-013 | 2А204НН-20(Т) | |
| ГТБВ.433642.01-014 | 2А204НН-40(Т) | |
| ГТБВ.433642.017-015 | 2А204НН-80(Т) | |
| ГТБВ.433642.017-016 | 2А204НН-160(Т) | |
| ГТБВ.433642.017-017 | 2А204НН-200(Т) | |

1 Размеры для справок.

2 Подключение датчика – согласно схеме электрической соединений.

3 Датчик крепить винтами и шайбами из комплекта монтажных частей с моментом затяжки 1,5...1,7 Нм, либо шпилькой М5 с моментом затяжки 2,5...2,7 Нм.

4 Поверхность крепления датчика должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05 с шероховатостью не хуже $\sqrt{}$Ra 2,5.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Ситников | | 02.09.20 |
| Пров. | | Корпичев | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | Кирпичев | | |

ГТБВ.433642.018 ГЧ

Датчик виброскорости 2А204НН-ХХ Габаритный чертеж

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | 4:1 |
| Лист | Листов 1 | |

GTLab

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2