

ГТБВ.433633.022 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № д.ц.д.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Вид спереди

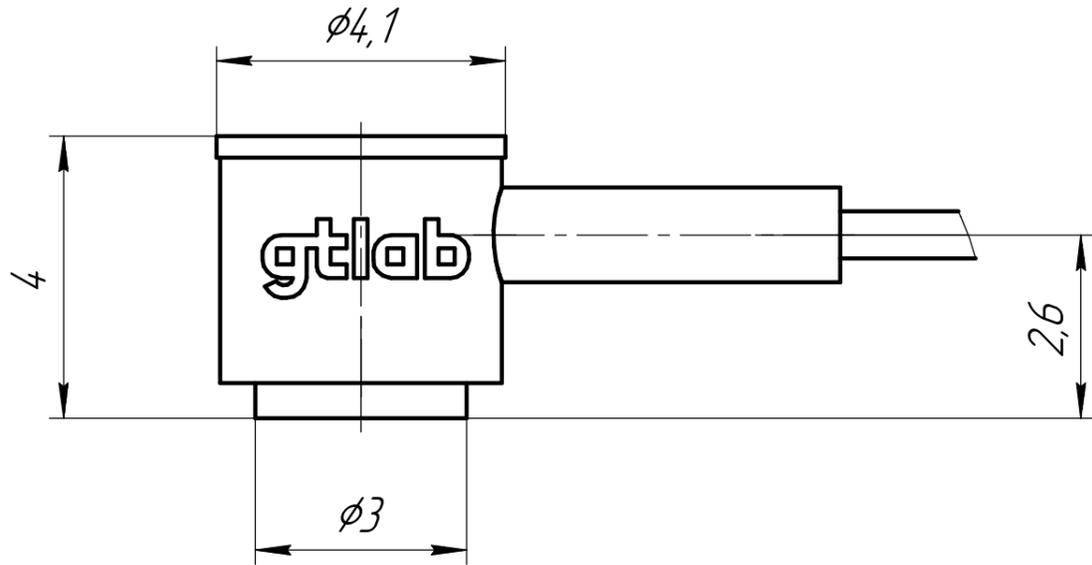

Вид сзади


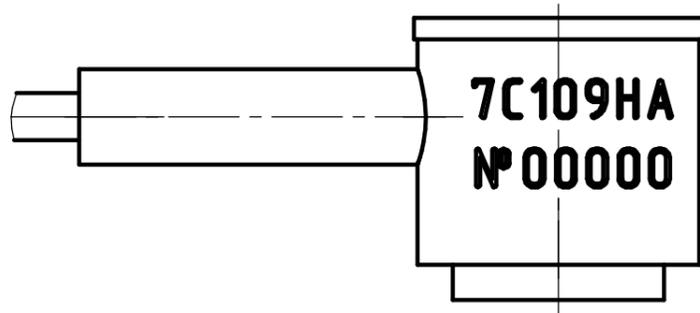


Схема электрическая принципиальная

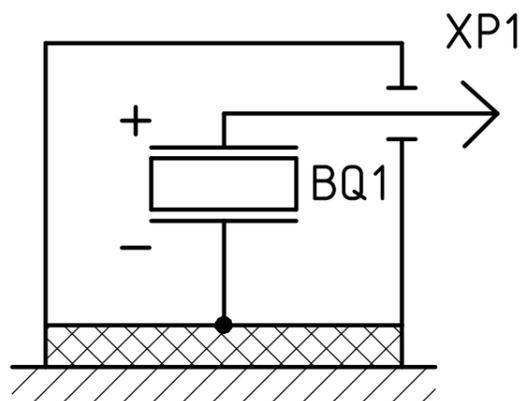

1 Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается преобразователь, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,01мм, с шероховатостью не хуже  $\sqrt{Ra} 1,25$ .

2 Обеспечить усилие поджатия преобразователя к поверхности объекта испытаний 2 ... 3Н

3 Для обеспечения акустического контакта на поверхность объекта испытаний рекомендуется нанести силиконовую жидкость или консистентную смазку любой стандартной марки.

4 При долгосрочных измерениях рекомендуется преобразователь устанавливать на объект испытаний на эпоксидный клей, например, ВК-9 ГОСТ 92-0948-74 или другой эпоксидный клей любой стандартной марки.

					<b>ГТБВ.433633.022 ГЧ</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь акустической эмиссии 7С109 Габаритный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Филатов						16,2 г	10:1
Проб.	Новоселов					Лист	Листов 1	
Т.контр.						<b>ООО "ГТЛАБ"</b>		
Н.контр.	Ситников							
Утв.	Кирпичев							