

ГТБВ.433633.023 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № д.ц.д.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Вид спереди

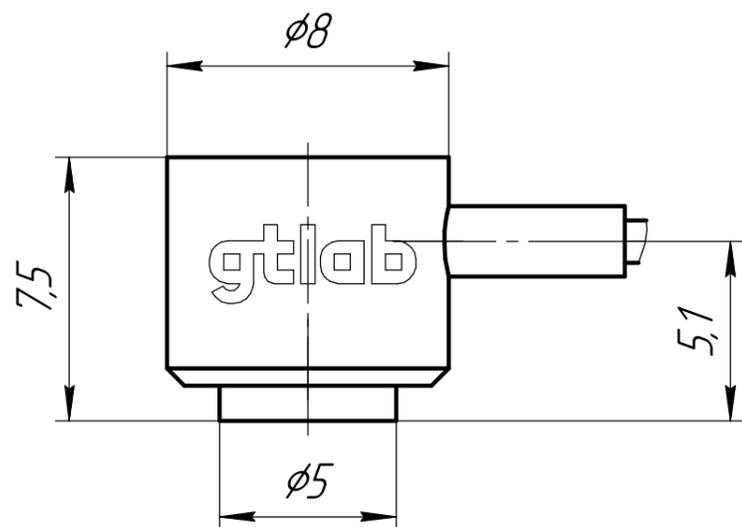

Вид сзади


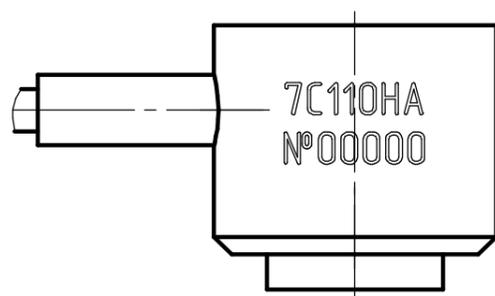


Схема электрическая принципиальная

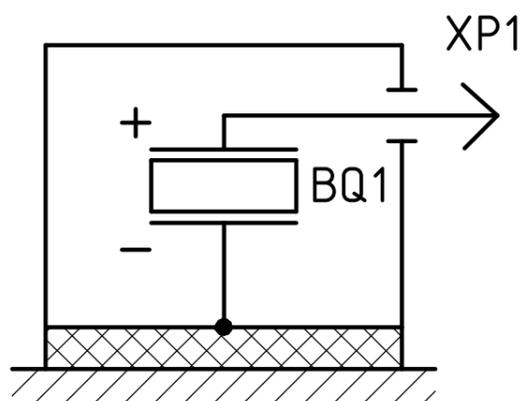

1 Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается преобразователь, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,01мм, с шероховатостью не хуже $\sqrt{Ra} 1,25$.

2 Обеспечить усилие поджатия преобразователя к поверхности объекта испытаний 3 ... 4,5Н

3 Для обеспечения акустического контакта на поверхность объекта испытаний рекомендуется нанести силиконовую жидкость или консистентную смазку любой стандартной марки.

4 При долгосрочных измерениях рекомендуется преобразователь устанавливать на объект испытаний на эпоксидный клей, например, ВК-9 ГОСТ 92-0948-74 или другой эпоксидный клей любой стандартной марки.

					ГТБВ.433633.023 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь акустической эмиссии 7С110 Габаритный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Филатов						4,3 г	5:1
Пров.	Новоселов					Лист	Листов 1	
Т.контр.						ООО "ГТЛАБ"		
Н.контр.	Ситников							
Утв.	Курпичев							